

flexGRIP® universal

Reference	Description	Size range	Device
UN511	universal 5-11 Fr	5-11 Fr	
UN1118	universal 11-18 Fr	11-18 Fr	
UN1825	universal 18-25 Fr	18-25 Fr	

flexGRIP® Foley

Reference	Description	Size range	Device
FOL1118	Foley 11-18 Fr	11-18 Fr	

flexGRIP® EPI/PNB

Reference	Description	Size range	Device
EP02	EPI/PNB 20-16 G	20-16 G	


flexGRIP® Alpha

Reference	Description	Size range	Device
ALPHA00	Alpha PICC/Midline	-	
ALPHASS	Alpha CVC/Arterial	-	


flexGRIP® PICC/CVC

Reference	Description	Size range	Device
PICC36	PICC 3-6 Fr	3-6 Fr	
CVC45900	CVC 4.5-9 Fr	4.5-9 Fr	



CVC459HS	CVC 4.5-9 Fr (with Horseshoe)	4.5-9 Fr	
----------	----------------------------------	----------	---

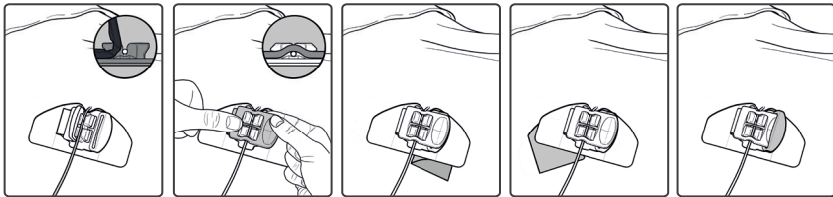


www.flex-grip.com

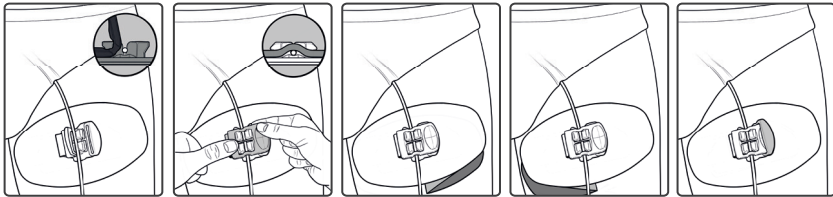


www.flex-grip.com

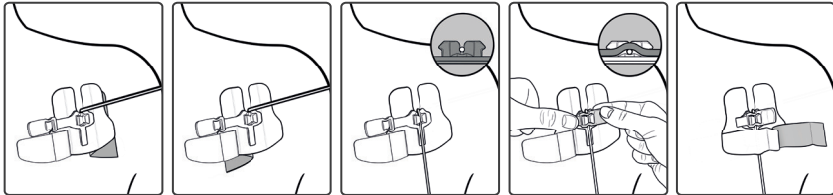


www.flex-grip.com

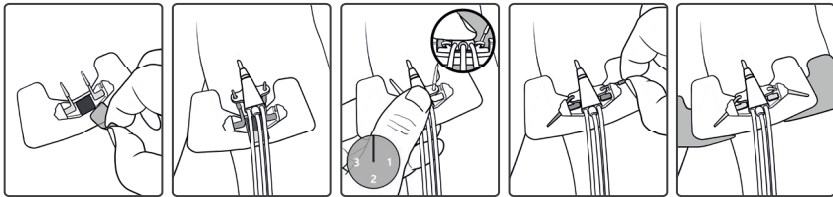

www.flex-grip.com

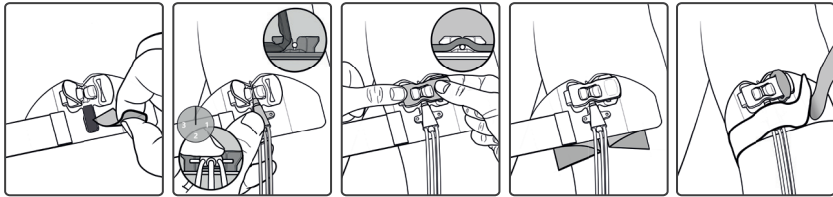

www.flex-grip.com

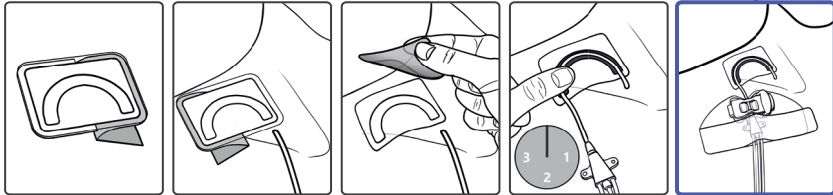

www.flex-grip.com

bedal International	AR	BG	CS	DA	DE	EL	ES	ET	FA	FI	FR
bedal International Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgium E info@bedal.be T +32(0)1128.69.02 - www.flex-grip.com Assembled in Poland, EU	مستعمل في بولندا والاتحاد الأوروبي تجميع وصف مقاس المنتج جهاز أداة طبية لا تستخدم إذا تلفلت العبوة تالفة تاريخ التصنيع رقم الإشعاع راجع تعليمات الاستخدام لا تكرر إعادة استخدام تاريخ الشركة المصنعة خالية من اللاتكس رقم الدليل تنبيه مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU نظام حزام واحد معقم نظام حزام واحد معقم مع تعليمات خارج بلد المنتج معرفة الجهاز الفريد الحفاظ على جفاف Katalogowa numer Pozor Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only. Single sterile barrier system Single sterile barrier system with protective packaging outside Country of manufacture Unique device identifier Keep dry	Сглобено в Полша, ЕС Преглед Описаније Димансион и размери Уредба Медицинско наредба Не користајте, ако целостта на упакованје е нарушена Дата на произвођаство Стерилизација преко радијације Номер на партија Видете упозорења за употреба Не користајте повторно Срок на горивост Произвођач Не садржи латекс Температурна граница Каталог број Предупређење Скенирајте QR кода, за да глеате упозорења и инструкције. Видео приказује само део инструкција. Единствени стерилни баријерни систем Единствени стерилни баријерни систем са заштитним омалом ван Страна на произвођачство Уникатни идентификатор устројства Сачувајте на сухо	Sestaveno v Polsku, EU Odkaz Popis Rozsah veľkostí Prístroj Zdravotnícký prostriedek Nepoužívajte, pokiaľ balenie nie je poškodené Datum výroby Sterilizované pomocou ožarovenia Číslo šarže Pozrite si inštrukcie k použitiu Nepoužívajte znovu Datum expirácie Výrobca Latex zdarma Teplota omezieť Katalóg číslo Pozor Naskenujte QR kód pro zobrazení instrukčního videa. Video zobrazuje IFU pouze částíčně. Jedini sterilni bariérový systém Jedini sterilni bariérový systém s ochranným obaloven vně Země výroby Jedinečný identifikátor zařízení Udržujte v suchu	Samlet i Polen, EU Reference Beskrivelse Størrelsesområde Enhed Medicinsk anordning Brug ikke hvis emballage er beskadiget Fremstillet i Polen Durch bestrahlung sterilisiert Artheds oplysninger Se brugsanvisninger Gar ingen genanvendelse Nicht wiederverwenden Anvendelsesdato Hersteller Producent Latexfri Temperaturlimite Katalognummer Forsigtig Vorsicht, warnhinweise Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen. Das Video zeigt die Gebrauchsanweisung nur teilweise. Einzelnes Sterilbarrieresystem Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen Herstellingsland Eindeutige Gerätekennung Opbevarer tørt Trocken halten	Zusammengebaut in Polen, EU Bezug Beschreibung Größenbereich Gerät Medizinprodukt Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt Herstellungsdatum Hersteller Verwendung bis zum datum Hersteller Frei von latex Temperaturgrenze Temperaturgrenze Katalognummer Vorsicht, warnhinweise Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen. Das Video zeigt die Gebrauchsanweisung nur teilweise. Einzelnes Sterilbarrieresystem Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen Herstellungsland Eindeutige Gerätekennung Opbevarer tørt Trocken halten	Συναρμολογήθηκε στην Πολωνία, ΕΕ Αναφορά Περιγραφή Εύρος μεγέθους Όργανο Ιατροτεχνολογικό προϊόν Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά Ημερομηνία κατασκευής Αποστειρώθηκε με τη χρήση ακτινοβολίας Αριθμός παρτίδας Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Να μην επαναχρησιμοποιείται Ημερομηνία λήξης Κατασκευαστής Λατέξ χωρίς Δεν επαναχρησιμοποιείται Οριο θερμοκρασίας Λίμιτ θερμοκρασίας Αριθμός καταλόγου Προσοχή Σάρξτε τον κωδικό QR για να δείτε βίντεο με οδηγίες. Το βίντεο δείχνει μόνο εν μέρη το IFU. Μονό σποστεριζωμένο συστήμα φραγμού Μονό σποστεριζωμένο συστήμα φραγμού με προστατευτική συσκευασία έξωθεν Χώρα παραγωγής Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής Κρατήστε το στεγνό	Ensamblado en Polonia, UE Referencia Descripción Rango de tamaño Dispositivo Producto sanitario Medicinaline seade Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud Tootmisajakuupv Steriliseeritud kiirgamisega Partii number Järgige kasutusjuhendit Ärge kasutakstage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexikaba Määratud temperatuur Temperatuuripiirang Nüumber de catalog Katalooginumber Precución Ettevastust Operutsuse vastamiseks skenege QR-koodi. Video näitab kasutusjuhendi ainult osaist. Ühekordne steriilne tõkkesüsteem Ühekordne steriilne tõkkesüsteem koos kaitselise pakendiga Tootja riik Seadme kordumatu identifikaator Hoida kuivana	Kokku pandud Poolas, EL-is Viide Kuvamus Laikm Toode Meditsiiniline seade Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud Tootmisajakuupv Steriliseeritud kiirgamisega Partii number Järgige kasutusjuhendit Ärge kasutakstage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexikaba Määratud temperatuur Temperatuuripiirang Nüumber de catalog Katalooginumber Precución Ettevastust Operutsuse vastamiseks skenege QR-koodi. Video näitab kasutusjuhendi ainult osaist. Ühekordne steriilne tõkkesüsteem Ühekordne steriilne tõkkesüsteem koos kaitselise pakendiga Tootja riik Seadme kordumatu identifikaator Hoida kuivana	مونتد في بولندا، الاتحاد الأوروبي تعليمات وصف مقاس المنتج جهاز منتج طبي لا تستخدم إذا تلفلت العبوة تالفة تاريخ توليد تم استيريلتها باستخدام الإشعاع رقم الدفعة راجع التعليمات لا تعيد استعماله تاريخ انتهاء الاستخدام تاريخ مصرف توليد بدون لاتكس محدوديت دماي شارد كاتالوج تنبه مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU نظام حزام استيريل بسيط نظام حزام استيريل بسيط مع تغليف واقية خارجي بلد التصنيع معرف الجهاز استيريل حفظ على جفاف Katalogowa numer Pozor Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only. Single sterile barrier system Single sterile barrier system with protective packaging outside Country of manufacture Unique device identifier Keep dry	Kasattu Puolassa, EU Viite Kuvamus Laikm Toode Lääkinnallinen laite Dispositif médical Sterilisoitu säteilyttämällä Steriliseeritud kiirgamisega Erännumero Katso käyttöohjeet Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut Valmistusajavälimäärä Date of fabrication Stérilisé par irradiation Erännumero Katsa käyttöohjeet Ei saa käyttää uudelleen Valmistaja Latexiton Säädetyt lämpötilat Lämpötilaraja Luettelonumero Numéro de catalogue Attention, mises en garde Attention, mises en garde Scannez le code QR pour voir la vidéo d'instruction. La vidéo ne montre que partiellement l'IFU. Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Identifiant unique de l'appareil Identifiant unique de l'appareil Pidä kuivana Conserver au sec	Référence La description Gamme de taille Appareil Dispositif médical Sterilisé par irradiation Date de fabrication Numéro de lot Consulter les instructions d'utilisation Ne pas réutiliser, usage unique Fabricant Sans latex Date limite d'utilisation Fabricant Sans latex Limite de température Limite de température Numéro de catalogue Numéro de catalogue Attention, mises en garde Attention, mises en garde Scannez le code QR pour voir la vidéo d'instruction. La vidéo ne montre que partiellement l'IFU. Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Identifiant unique de l'appareil Identifiant unique de l'appareil Conserver au sec Conserver au sec
bedal International Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgium E info@bedal.be T +32(0)1128.69.02 - www.flex-grip.com Assembled in Poland, EU	مستعمل في بولندا والاتحاد الأوروبي تجميع وصف مقاس المنتج جهاز أداة طبية لا تستخدم إذا تلفلت العبوة تالفة تاريخ التصنيع رقم الإشعاع راجع تعليمات الاستخدام لا تكرر إعادة استخدام تاريخ الشركة المصنعة خالية من اللاتكس رقم الدليل تنبيه مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU نظام حزام واحد معقم نظام حزام واحد معقم مع تعليمات خارج بلد المنتج معرفة الجهاز الفريد الحفاظ على جفاف Katalogowa numer Pozor Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only. Single sterile barrier system Single sterile barrier system with protective packaging outside Country of manufacture Unique device identifier Keep dry	Сглобено в Полша, ЕС Преглед Описаније Димансион и размери Уредба Медицинско наредба Не користајте, ако целостта на упакованје е нарушена Дата на произвођаство Стерилизација преко радијације Номер на партија Видете упозорења за употреба Не користајте повторно Срок на горивост Произвођач Не садржи латекс Температурна граница Каталог број Предупређење Скенирајте QR кода, за да глеате упозорења и инструкције. Видео приказује само део инструкција. Единствени стерилни баријерни систем Единствени стерилни баријерни систем са заштитним омалом ван Страна на произвођачство Уникатни идентификатор устројства Сачувајте на сухо	Sestaveno v Polsku, EU Odkaz Popis Rozsah veľkostí Prístroj Zdravotnícký prostriedek Nepoužívajte, pokiaľ balenie nie je poškodené Datum výroby Sterilizované pomocou ožarovenia Číslo šarže Pozrite si inštrukcie k použitiu Nepoužívajte znovu Datum expirácie Výrobca Latex zdarma Teplota omezieť Katalóg číslo Pozor Naskenujte QR kód pro zobrazení instrukčního videa. Video zobrazuje IFU pouze částíčně. Jedini sterilni bariérový systém Jedini sterilni bariérový systém s ochranným obaloven vně Země výroby Jedinečný identifikátor zařízení Udržujte v suchu	Samlet i Polen, EU Reference Beskrivelse Størrelsesområde Enhed Medicinsk anordning Brug ikke hvis emballage er beskadiget Fremstillet i Polen Durch bestrahlung sterilisiert Artheds oplysninger Se brugsanvisninger Gar ingen genanvendelse Nicht wiederverwenden Anvendelsesdato Hersteller Producent Latexfri Temperaturlimite Katalognummer Forsigtig Vorsicht, warnhinweise Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen. Das Video zeigt die Gebrauchsanweisung nur teilweise. Einzelnes Sterilbarrieresystem Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen Herstellingsland Eindeutige Gerätekennung Opbevarer tørt Trocken halten	Zusammengebaut in Polen, EU Bezug Beschreibung Größenbereich Gerät Medizinprodukt Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt Herstellungsdatum Hersteller Verwendung bis zum datum Hersteller Frei von latex Temperaturgrenze Temperaturgrenze Katalognummer Vorsicht, warnhinweise Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo anzusehen. Das Video zeigt die Gebrauchsanweisung nur teilweise. Einzelnes Sterilbarrieresystem Einzelnes Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung außen Herstellungsland Eindeutige Gerätekennung Opbevarer tørt Trocken halten	Συναρμολογήθηκε στην Πολωνία, ΕΕ Αναφορά Περιγραφή Εύρος μεγέθους Όργανο Ιατροτεχνολογικό προϊόν Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά Ημερομηνία κατασκευής Αποστειρώθηκε με τη χρήση ακτινοβολίας Αριθμός παρτίδας Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Να μην επαναχρησιμοποιείται Ημερομηνία λήξης Κατασκευαστής Λατέξ χωρίς Δεν επαναχρησιμοποιείται Οριο θερμοκρασίας Λίμιτ θερμοκρασίας Αριθμός καταλόγου Προσοχή Σάρξτε τον κωδικό QR για να δείτε βίντεο με οδηγίες. Το βίντεο δείχνει μόνο εν μέρη το IFU. Μονό σποστεριζωμένο συστήμα φραγμού Μονό σποστεριζωμένο συστήμα φραγμού με προστατευτική συσκευασία έξωθεν Χώρα παραγωγής Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής Κρατήστε το στεγνό	Ensamblado en Polonia, UE Referencia Descripción Rango de tamaño Dispositivo Producto sanitario Medicinaline seade Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud Tootmisajakuupv Steriliseeritud kiirgamisega Partii number Järgige kasutusjuhendit Ärge kasutakstage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexikaba Määratud temperatuur Temperatuuripiirang Nüumber de catalog Katalooginumber Precución Ettevastust Operutsuse vastamiseks skenege QR-koodi. Video näitab kasutusjuhendi ainult osaist. Ühekordne steriilne tõkkesüsteem Ühekordne steriilne tõkkesüsteem koos kaitselise pakendiga Tootja riik Seadme kordumatu identifikaator Hoida kuivana	Kokku pandud Poolas, EL-is Viide Kuvamus Laikm Toode Meditsiiniline seade Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud Tootmisajakuupv Steriliseeritud kiirgamisega Partii number Järgige kasutusjuhendit Ärge kasutakstage Kasutamise lõpptähtaeg Tootja Latexikaba Määratud temperatuur Temperatuuripiirang Nüumber de catalog Katalooginumber Precución Ettevastust Operutsuse vastamiseks skenege QR-koodi. Video näitab kasutusjuhendi ainult osaist. Ühekordne steriilne tõkkesüsteem Ühekordne steriilne tõkkesüsteem koos kaitselise pakendiga Tootja riik Seadme kordumatu identifikaator Hoida kuivana	مونتد في بولندا، الاتحاد الأوروبي تعليمات وصف مقاس المنتج جهاز منتج طبي لا تستخدم إذا تلفلت العبوة تالفة تاريخ توليد تم استيريلتها باستخدام الإشعاع رقم الدفعة راجع التعليمات لا تعيد استعماله تاريخ انتهاء الاستخدام تاريخ مصرف توليد بدون لاتكس محدوديت دماي شارد كاتالوج تنبه مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU نظام حزام استيريل بسيط نظام حزام استيريل بسيط مع تغليف واقية خارجي بلد التصنيع معرف الجهاز استيريل حفظ على جفاف Katalogowa numer Pozor Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only. Single sterile barrier system Single sterile barrier system with protective packaging outside Country of manufacture Unique device identifier Keep dry	Kasattu Puolassa, EU Viite Kuvamus Laikm Toode Lääkinnallinen laite Dispositif médical Sterilisoitu säteilyttämällä Steriliseeritud kiirgamisega Erännumero Katso käyttöohjeet Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut Valmistusajavälimäärä Date of fabrication Stérilisé par irradiation Erännumero Katsa käyttöohjeet Ei saa käyttää uudelleen Valmistaja Latexiton Säädetyt lämpötilat Lämpötilaraja Luettelonumero Numéro de catalogue Attention, mises en garde Attention, mises en garde Scannez le code QR pour voir la vidéo d'instruction. La vidéo ne montre que partiellement l'IFU. Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Identifiant unique de l'appareil Identifiant unique de l'appareil Pidä kuivana Conserver au sec	Référence La description Gamme de taille Appareil Dispositif médical Sterilisé par irradiation Date de fabrication Numéro de lot Consulter les instructions d'utilisation Ne pas réutiliser, usage unique Fabricant Sans latex Date limite d'utilisation Fabricant Sans latex Limite de température Limite de température Numéro de catalogue Numéro de catalogue Attention, mises en garde Attention, mises en garde Scannez le code QR pour voir la vidéo d'instruction. La vidéo ne montre que partiellement l'IFU. Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Système de barrière stérile unique avec emballage de protection à l'extérieur Identifiant unique de l'appareil Identifiant unique de l'appareil Conserver au sec Conserver au sec
bedal International Agoralaan A bis-3590 Diepenbeek Belgium E info@bedal.be T +32(0)1128.69.02 - www.flex-grip.com Assembled in Poland, EU	مستعمل في بولندا والاتحاد الأوروبي تجميع وصف مقاس المنتج جهاز أداة طبية لا تستخدم إذا تلفلت العبوة تالفة تاريخ التصنيع رقم الإشعاع راجع تعليمات الاستخدام لا تكرر إعادة استخدام تاريخ الشركة المصنعة خالية من اللاتكس رقم الدليل تنبيه مسح رمز الاستجابة السريعة فقط IFU نظام حزام واحد معقم نظام حزام واحد معقم مع تعليمات خارج بلد المنتج معرفة الجهاز الفريد الحفاظ على جفاف Katalogowa numer Pozor Scan QR code to view instruction video. Video only shows IFU part only. Single sterile barrier system Single sterile barrier system with protective packaging outside Country of manufacture Unique device identifier Keep dry	Сглобено в Полша, ЕС Преглед Описаније Димансион и размери Уредба Медицинско наредба Не користајте, ако целостта на упакованје е нарушена Дата на произвођаство Стерилизација преко радијације Номер на партија Видете упозорења за употреба Не користајте повторно Срок на горивост Произвођач Не садржи латекс Температурна граница Каталог број Предупређење Скенирајте QR кода, за да глеате упозорења и инструкције. Видео приказује само део инструкција. Единствени стерилни баријерни систем Единствени стерилни баријерни систем са заштитним омалом ван Страна на произвођачство Уникатни идентификатор устројства Сачувајте на сухо	Sestaveno v Polsku, EU Odkaz Popis Rozsah veľkostí Prístroj Zdravotnícký prostriedek Nepoužívajte, pokiaľ balenie nie je poškodené Datum výroby Sterilizované pomocou ožarovenia Číslo šarže Pozrite si inštrukcie								